

وزارة الصحة

Ministère de la Santé

المركز الوطني لأمراض القلب
Centre National de Cardiologie

لجنة إبرام الصفقات العمومية
Commission de Passation
des Marchés Publics (CPMP)

نواكشوط، في 19 DEC 2024

Numéro _____ الرقم

A

Messieurs les candidats à l'appel d'offre N° 05/F/CNC/CPMP-CNC/2024

Référence : DAO N° 05/F/CNC/CPMP-CNC/2024


Objet : Clarifications

Suite à une demande de clarification d'un candidat, portant sur l'appel d'offre N° 05/F/CNC/CPMP-CNC/2024, relatif à l'acquisition, l'installation et la mise en service des équipements de l'unité de stérilisation et ses accessoires y compris les travaux d'aménagement du local, j'ai l'honneur de vous transmettre les éléments ci-après :

Demande 1 : Pourriez-vous préciser la hauteur, la largeur et la surface totale en mètres carrés des zones à recouvrir en inox ?

Clarification1 : voir figure ci-après.

Représentation graphique de la zone à revêtir en inox pour un coté, à prévoir pour deux cotés (zone stérile et zone non stérile).

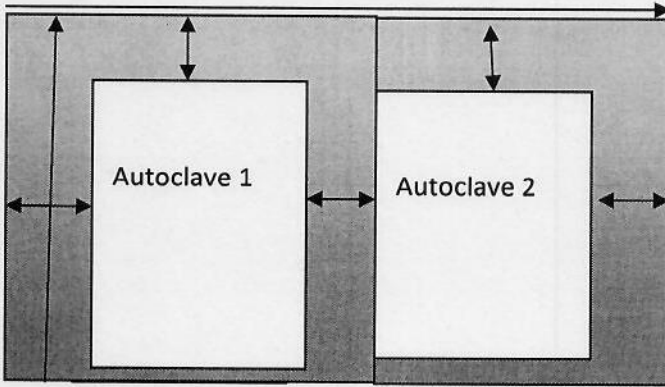

Clés de lecture

→ = 4.40 m

↑ = 2.73

↔ = 1 m

Demande 2 : Avez-vous une préférence pour un type particulier d'inox ou des exigences concernant l'épaisseur et la finition ?

Clarification 2 : Le type d'inox préféré est AISI 304 L, épaisseur 05 mm, finition brossée et polie

Demande 3 : Existe-t-il des contraintes particulières concernant l'accès à la zone ou des conditions spécifiques à prendre en compte pour l'installation?

Clarification 3 : existence d'un ascenseur avec une capacité de charge de 1600 kg, hauteur 2.10 m et largeur 1.30 m et profondeur 2.40 m. D'autres options sont possibles au choix suite à la visite des lieux. Nous vous invitons à visiter les lieux pour plus de précisions.

Ahmedou Sidi Mahmoud

